

Empresa avaliada: Criffer
Setor: Lab

Empresa avaliadora: Criffer
Realizado por: Jonathan Dias

Ensaio

Data: 03/04/2019
Duração: 00:30:00
Início: 11:15:26

Tempo em pausa: 00:00:00
Fim: 11:43:26

Resultado da avaliação

Índice do instrumento	Modelo do instrumento	IBUTGi	IBUTGe
1	PROTEMP 4	22,20	22,20

Observações

Felipe Ferreira
Registro: 123456


Informações do instrumento

PROTEMP 4(018105015)
 Cert. cal.: 73.282.A-10.18 10/10/2018

Resultados parciais

Bulbo seco [°C]	Bulbo úmido [°C]	Globo [°C]	IBUTGi [°C]	IBUTGe [°C]
Máx: 23,30	Máx: 23,00	Máx: 22,90	Média: 22,20	Média: 22,20
Mín: 22,30	Mín: 21,80	Mín: 22,40		

Gráfico

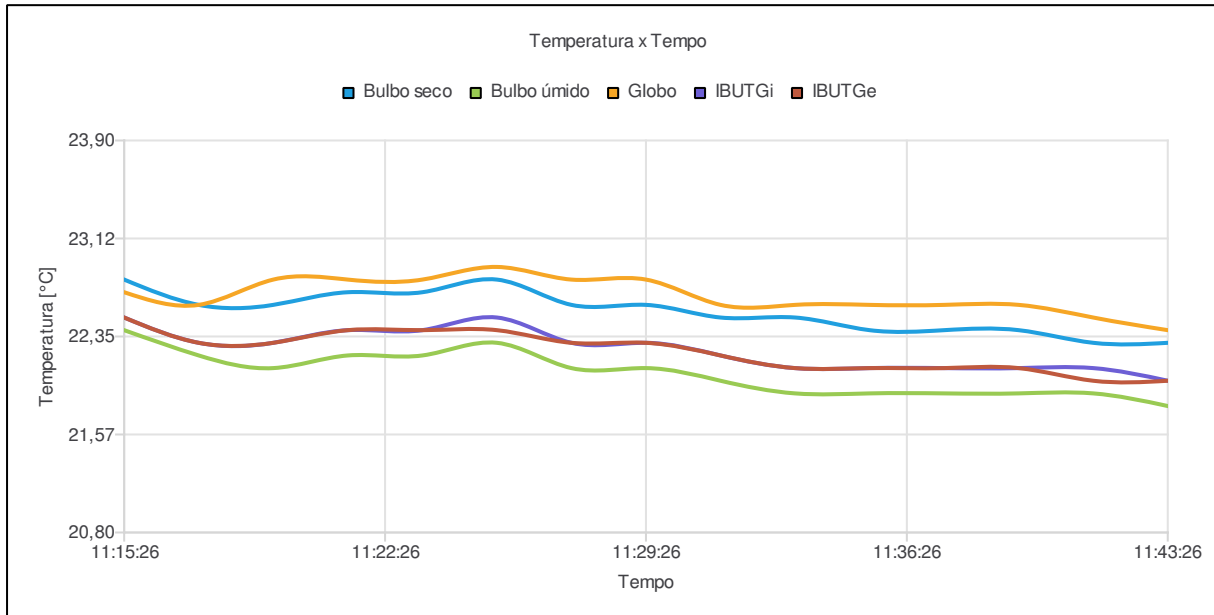

Ind	D/H	Ts [°C]	Tu [°C]	Tg [°C]	Ii [°C]	Ie [°C]
001	11:15:26	22,8	22,4	22,7	22,5	22,5
002	11:17:26	22,6	22,2	22,6	22,3	22,3
003	11:19:26	22,6	22,1	22,8	22,3	22,3
004	11:21:26	22,7	22,2	22,8	22,4	22,4
005	11:23:26	22,7	22,2	22,8	22,4	22,4
006	11:25:26	22,8	22,3	22,9	22,5	22,4
007	11:27:26	22,6	22,1	22,8	22,3	22,3
008	11:29:26	22,6	22,1	22,8	22,3	22,3
009	11:31:26	22,5	22,0	22,6	22,2	22,2
010	11:33:26	22,5	21,9	22,6	22,1	22,1
011	11:35:26	22,4	21,9	22,6	22,1	22,1
012	11:37:26	22,4	21,9	22,6	22,1	22,1
013	11:39:26	22,4	21,9	22,6	22,1	22,1
014	11:41:26	22,3	21,9	22,5	22,1	22,0
015	11:43:26	22,3	21,8	22,4	22,0	22,0